


Kund och anläggning	Serviceман/sign	Datum utförande
Uddevalla Kraft Panna 1 efter RGK	Per Jacobsson	2019-10-09

AMS-Automatiskt mätsystem	Spädustrustning
Gasmät CEMSII Parameter CO Mätområde 0-1500 mg/Nm3 Serie nr:0163499	Brook Instrument Datum kalcertifikat

Parameter	sort	värde	Resultat
ELV-Emission Limit Value	mg/Nm3		Godkänd
Kalgas CO	mg/Nm3	1000	Alla restsummor är lägre än 5%
Kalgas CO	ppm		
Mätområde AMS NO	mg/Nm3	0-1500	

Konc. %	Följd	Avläsning	X _i refmaterial	Y _i AMS	d _{c-rel} %
	1-6	1-3	mg/Nm ³	mg/Nm ³	
0	6	1	0,0	0,1	-0,2
		2	0,0	0,0	
		3	0,0	0,1	
0	5	1	0,0	0,0	-0,2
		2	0,0	0,1	
		3	0,0	0,1	
20	4	1	200,0	203,6	0,4
		2	200,0	203,6	
		3	200,0	203,6	
40	3	1	400,0	392,9	0,0
		2	400,0	392,7	
		3	400,0	392,6	
60	2	1	600,0	590,1	0,1
		2	600,0	587,4	
		3	600,0	587,5	
80	1	1	800,0	778,8	-0,2
		2	800,0	779,5	
		3	800,0	780,3	

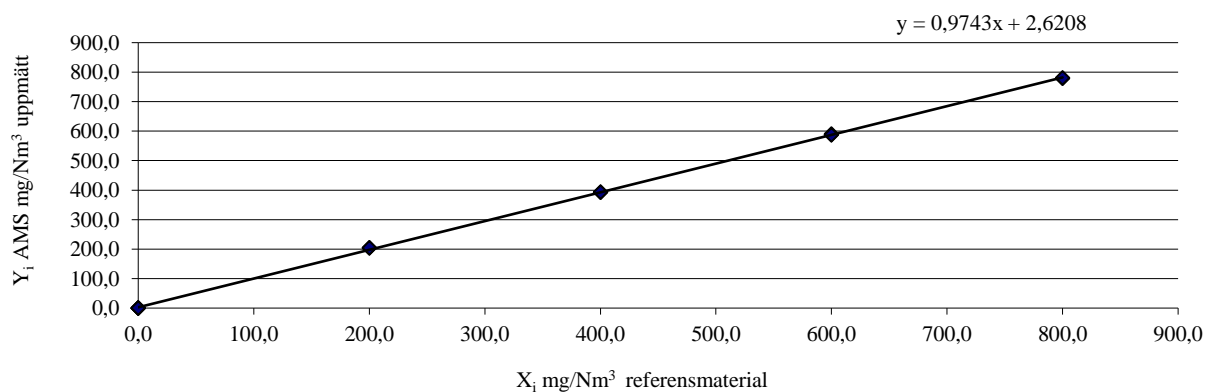

Övrigt: